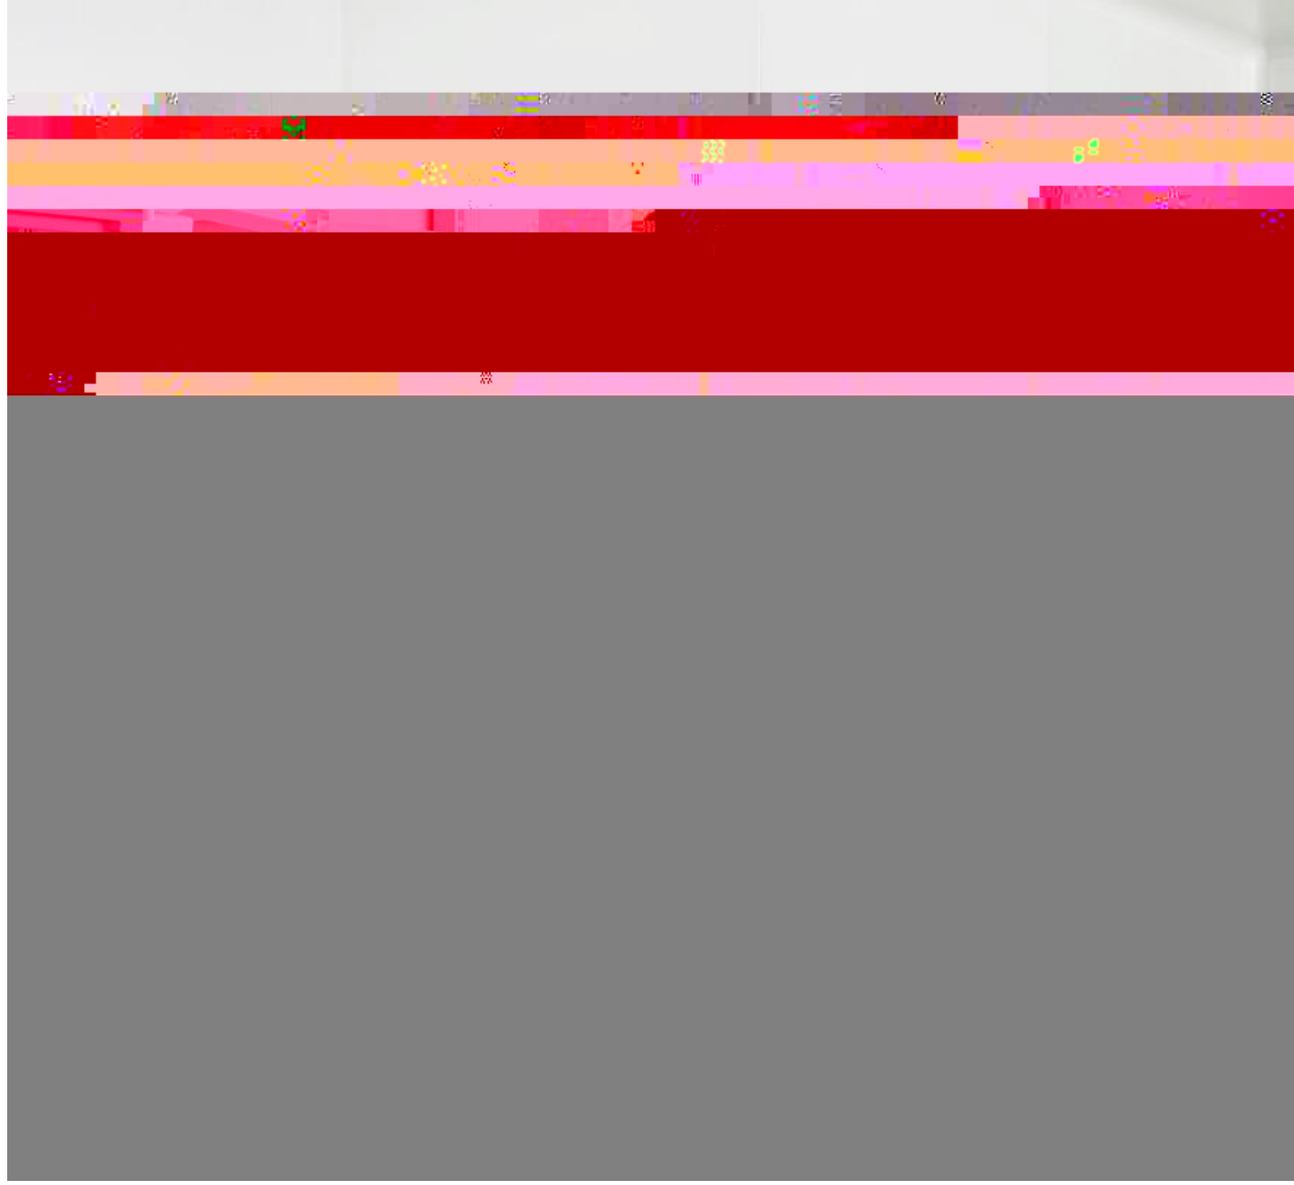

智能一体化 引领分子诊断“芯”时代

HPV微流控核酸检测系统

BHF-VI

BOHUI 博晖创新

CONTACT US

: 9

: 010-88850168

http: //www.bohui-tech.com

: 300318

FourinALL FULLY AUTOMATIC

4

,

,

STEP 01

STEP 02

STEP 03

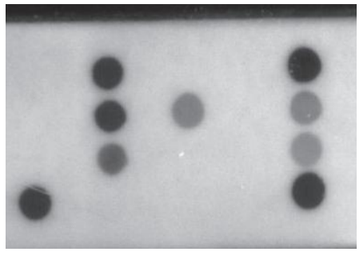

STEP 04

3.5

HOLOTYPE FourinALL

GenPlex®

PCR “ ”

24/28

24 17 HPV 7 , 16 18 HPV

16 58 52 18 33 68 53 66 HPV

28 24 HR-HPV 26 LR-HPV 40 54 61 HPV

17/18

16	18	26	31	33	35	39	45	51	52	53	56	58	59	66	68	73	82

7/10

6	11	40	42	43	44	54	61	81	83

2001

(:300318)

“ ”

系统描述	微流控全自动核酸检测系统
检测通量	24 人份；12 人份；8 人份
检测时间	4 小时
试剂包装	